


СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

УТВЕРЖДАЮ
Главный метролог
ФБУ "Ростест-Москва"



К.В. Чекирда

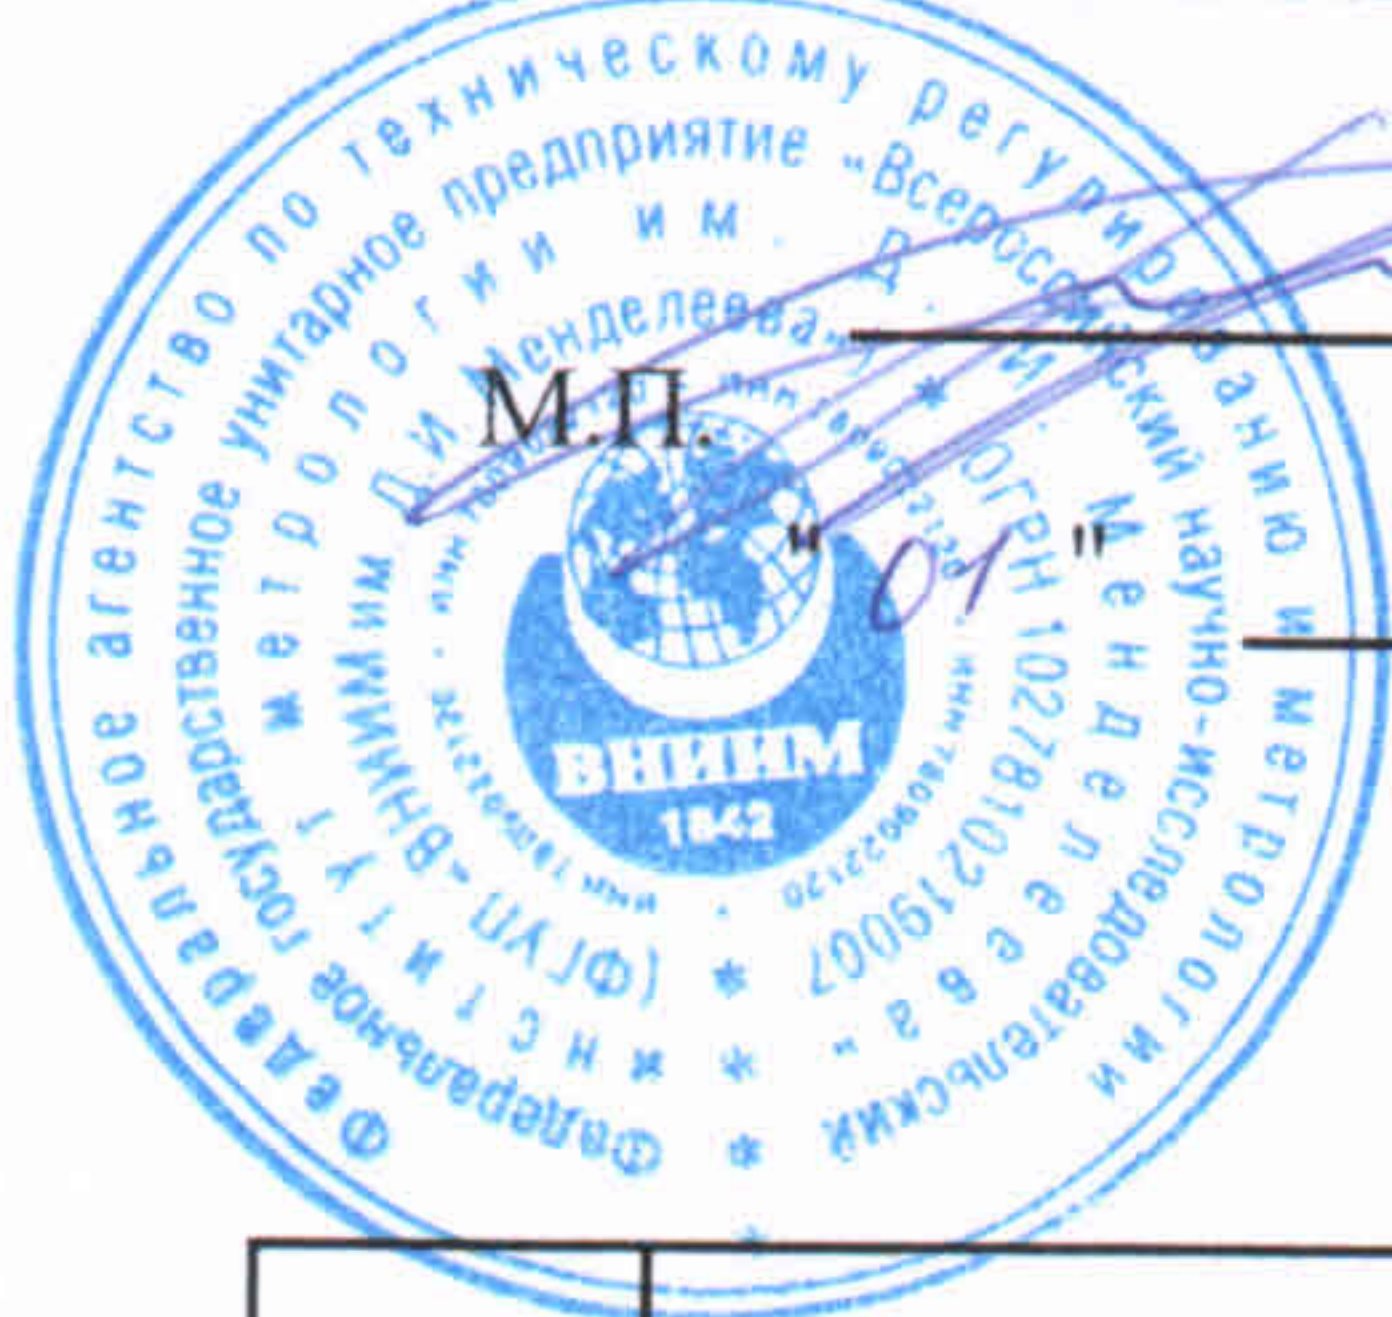


А.Е. Коломин

ноября 2017 г.

ноября 2017 г.

Локальная поверочная схема № 444-0028
для средств измерений массы литра зерна (натуры зерна)

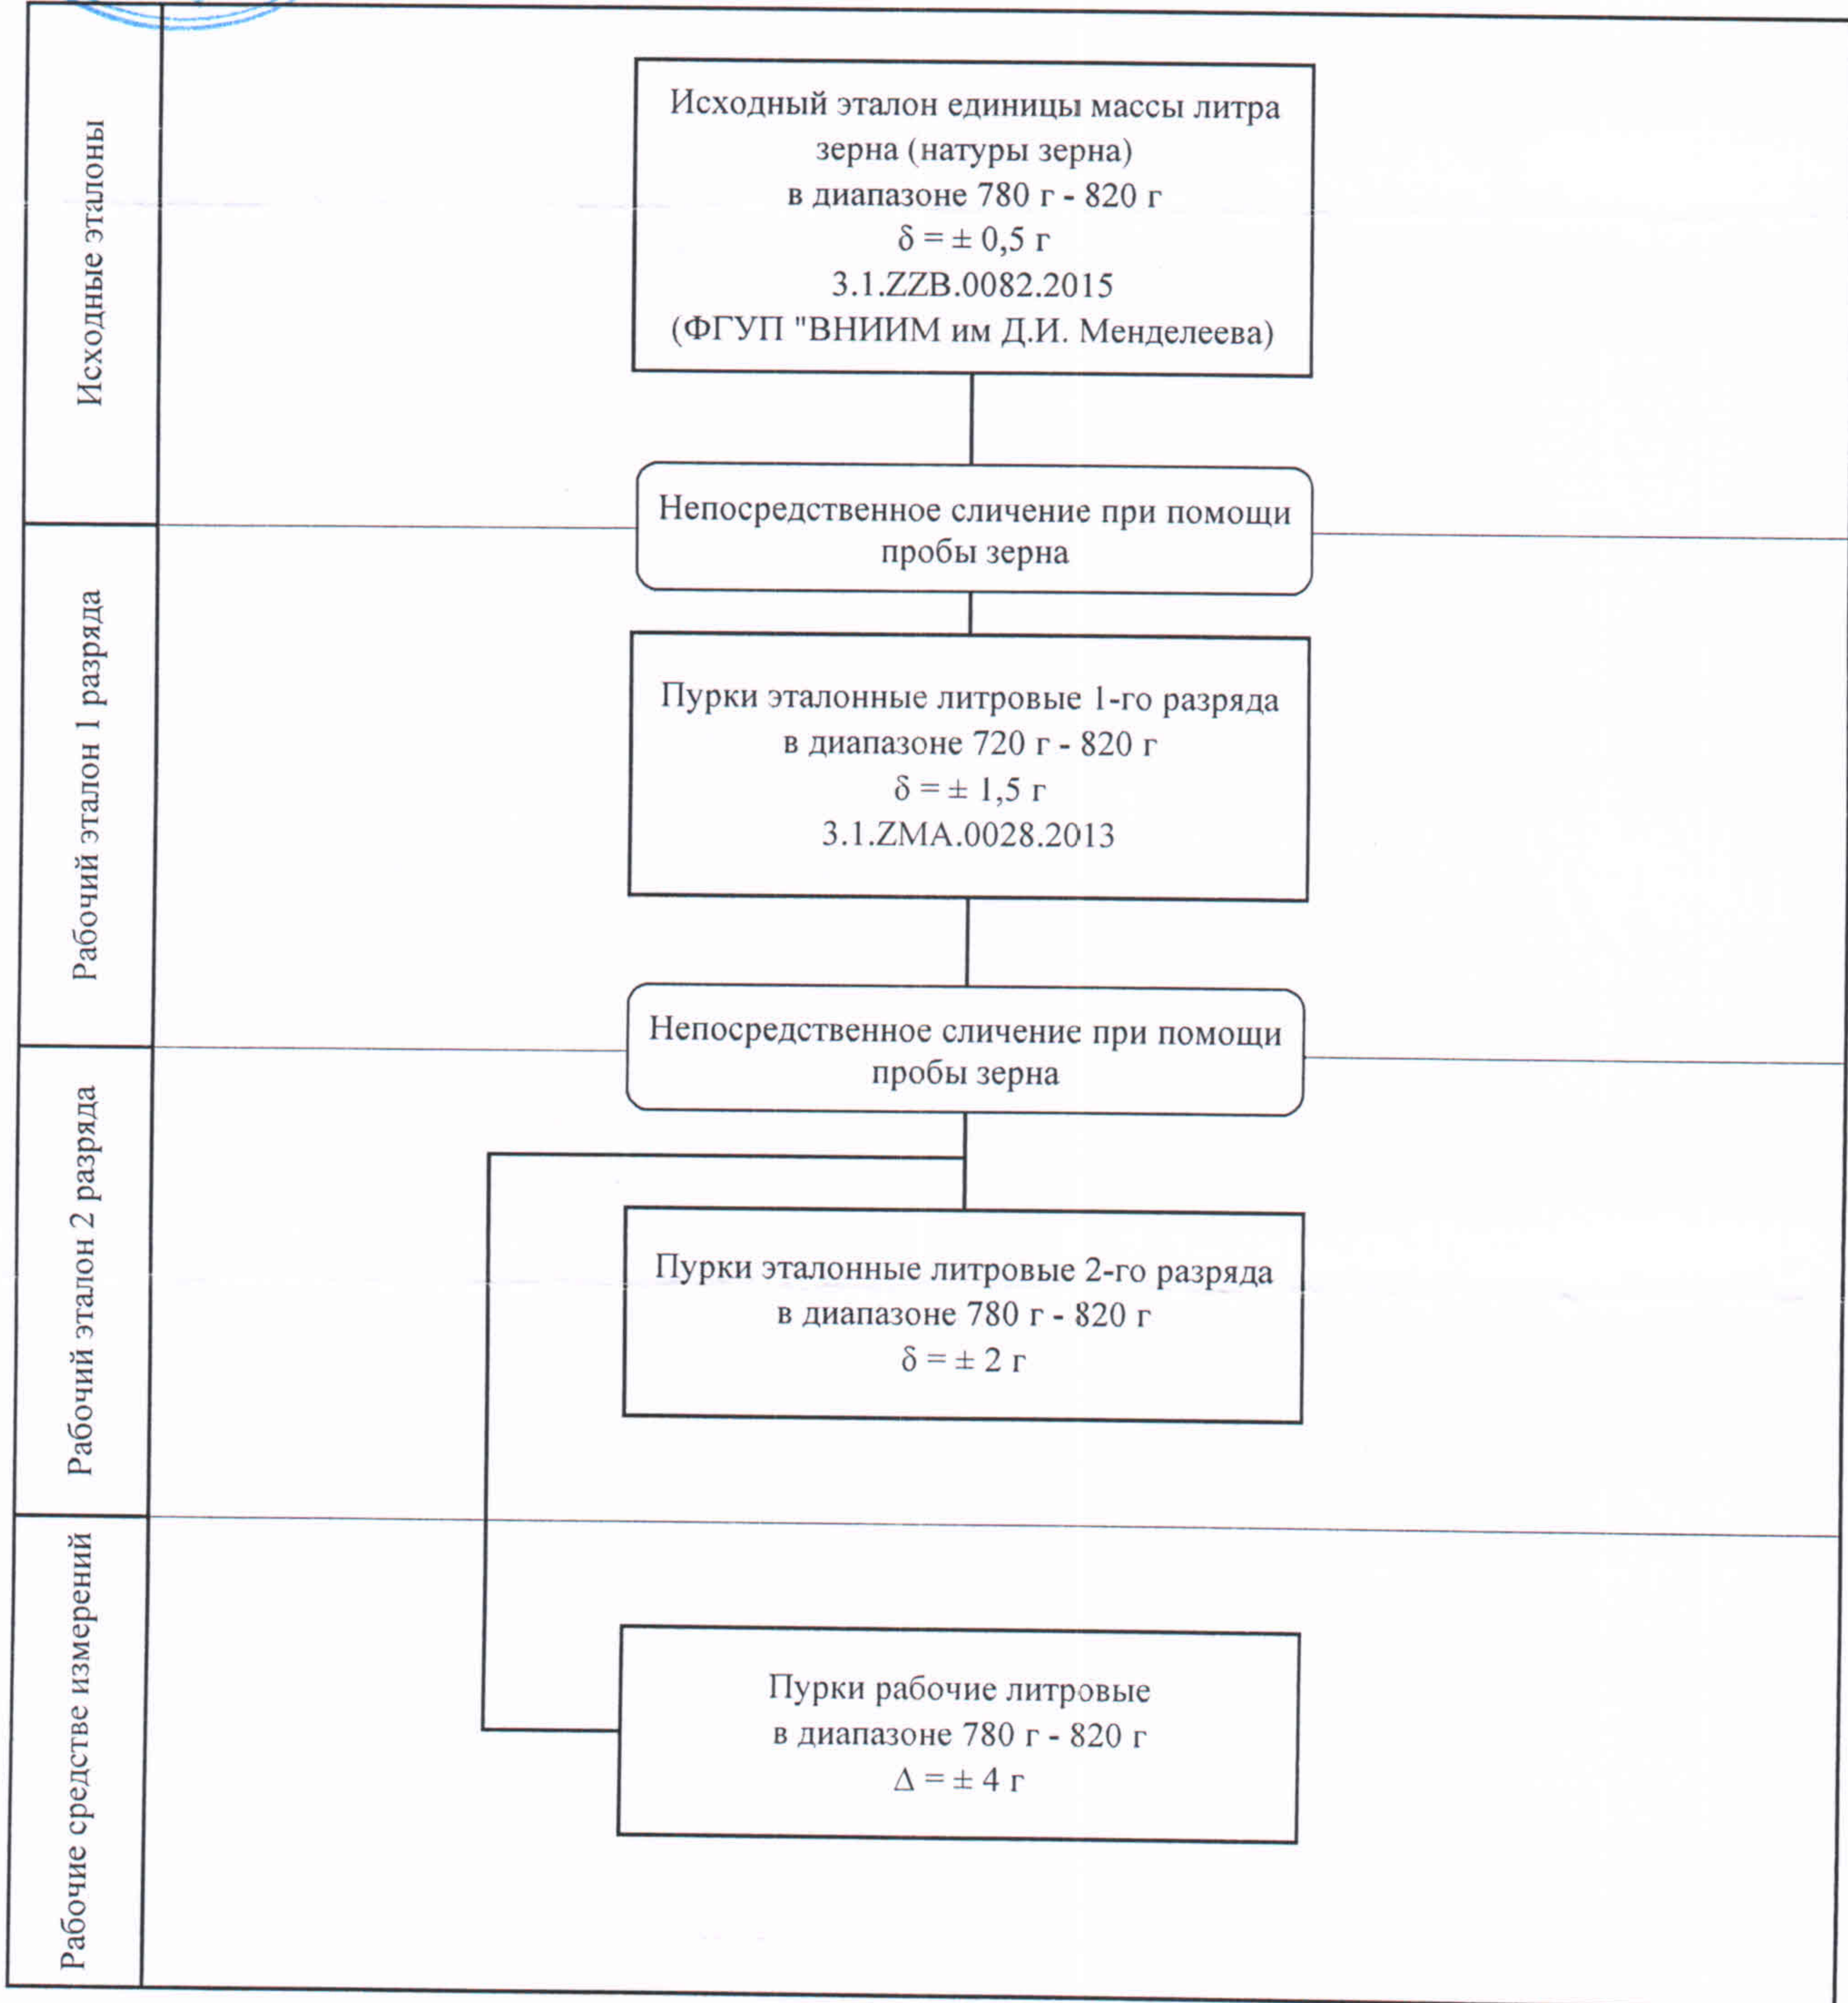

Начальник лаборатории 444

А.С. Фефилов